

# LP 50 II

## owners manual

■ K-110 ■ Q/K

■ ENGLISH ■ SPANISH ■ FRENCH



*Leggett & Platt*  
CONSUMER PRODUCTS

## CONTENTS

Advisory.....	3
Assembly .....	4
Remote Control Function.....	9
Tandem Syncing (One remote control operating both bases in tandem) .....	10
Troubleshooting.....	11

*Spanish translation begins on page 12.  
La traducción en español inicia en la página 12.  
French Canadian translation begins on page 22.  
La traduction en Français débute à la page 22.*



### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**

If adjustable base does not operate or if parts are missing, call:  
1-800-888-3078

For customer service in French, call: 1-877-452-2665

Do not contact retail store or dealer.

## ADVISORY

### IMPORTANT INFORMATION

#### READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT



#### WARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

#### ELECTRICAL RATING

Input rating: 100-130V, 50/60Hz, 2.5A max. Output rating: 29VDC, 1.8A.

#### ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

#### WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control and power down box battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

#### LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

#### HOSPITAL USE DISCLAIMER

*This base is designed for in-home use only.* It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases. Manufacturer makes no representation or warranty that the adjustable base constitutes a medical device or is suitable for medical or therapeutic use.

#### LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment.

#### PRODUCT RATINGS

The base lift motors are *not* designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed five (5) minutes over a fifty (50) minute period, or approximately 10% duty cycle. Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 700 lb (317 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. **Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.**

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components. CFR 1633 approved for use with most mattresses.

#### SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

#### SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

#### LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

## ASSEMBLY

To assemble adjustable base, complete the following procedure:

### STEP 1


Place adjustable base shipping container on solid, level surface. Remove top section of shipping container. Remove packing material. Carefully, lift adjustable base out of bottom section of shipping container and place on clean surface. Allow for enough space to unfold base in setup area.

### STEP 2

Raise the top section of the adjustable base and remove hardware / leg boxes.




### STEP 3

Remove cotter pin and clevis pin from hinge (one on each side) and fold adjustable base out flat (FIGURE 1).

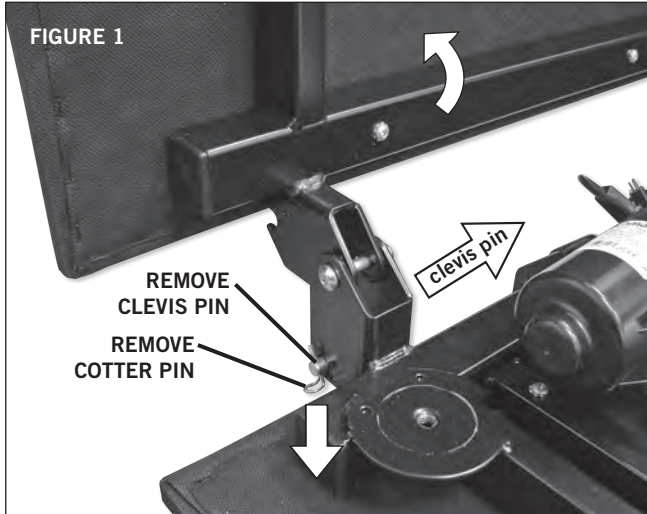

### STEP 4

When base is flat, reinsert clevis pin and cotter pin (one on each side) (FIGURE 2).

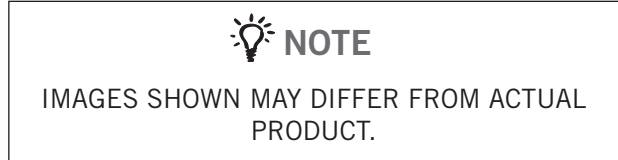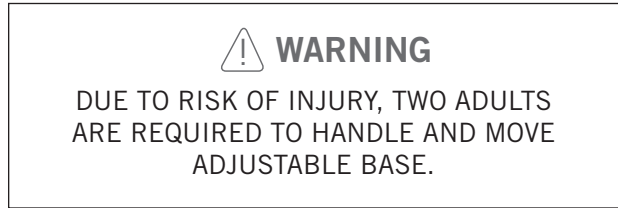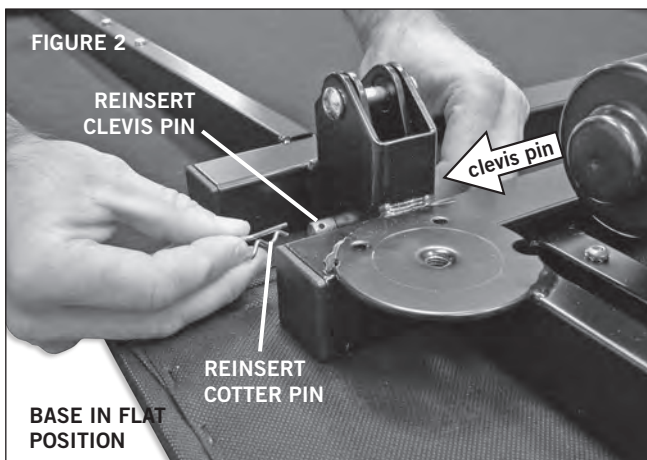

## ASSEMBLY

### STEP 5

Open the hardware box and verify the following items are included:

- (6 or 8) Bed legs (depending on base type)
- (1) Remote Control
- (1) Mattress Retainer (zip-tied to base frame)
- (1) Sync Cable (split sizes only)
- (1) Owners Manual



**LEG**  
(6 or 8 pieces,  
depending on base  
type)




**OWNERS MANUAL**



**REMOTE CONTROL**



**SYNC CABLE**  
(split sizes only)

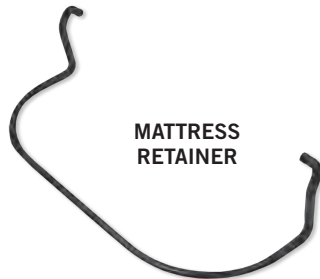

**MATTRESS  
RETAINER**

## ASSEMBLY



### STEP 6

Remove remaining packaging. Cut the zip-tie and remove the mattress retainer. **CAUTION: EXERCISE CAUTION WHEN USING SHARP INSTRUMENTS.**

**If setting up two twin bases to operate as one king base (tandem setup), refer to Tandem Syncing section of manual before proceeding.**

### STEP 7

Plug remote control cord into base motor cable (FIGURE 3). Pivot cable latch downward and snap cable latch in closed position (FIGURE 4). **Note: Align pins before inserting plugs (FIGURE 4). Do not weave cords through base structure.**

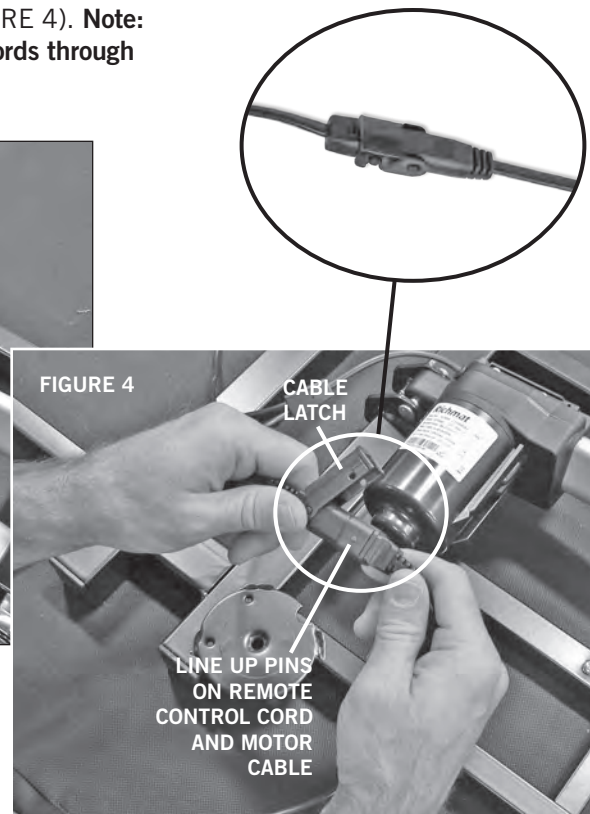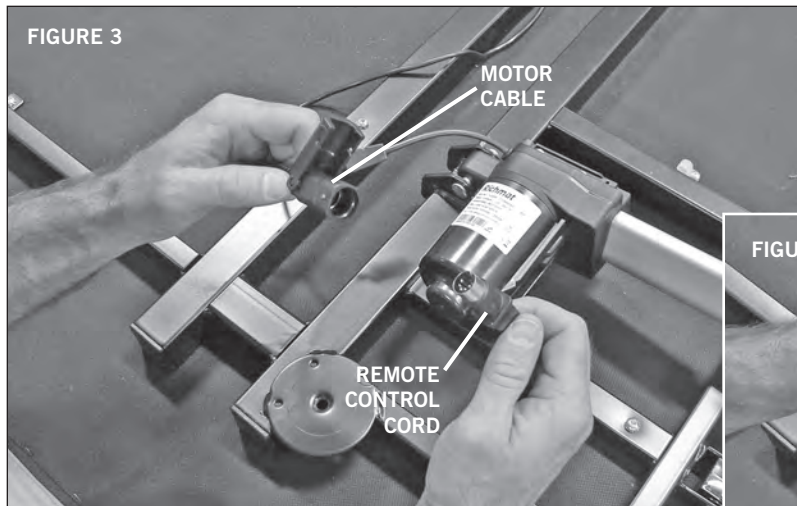

### STEP 8

Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet.

**Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).**



### WARNING


POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS. DO NOT WEAVE CORDS THROUGH BASE STRUCTURE.

## ASSEMBLY

### STEP 9


Screw legs into the leg plates on the base frame (FIGURES 5 and 6). Tighten securely.

**FIGURE 5**

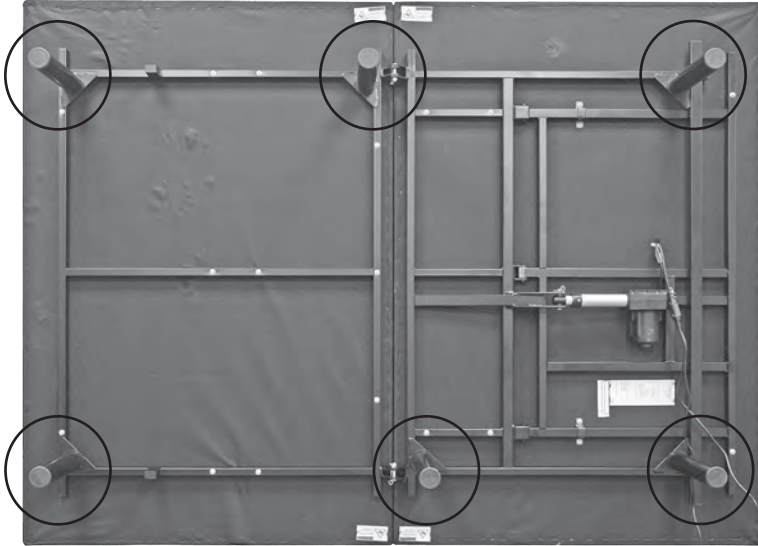

**QUEEN BASES  
HAVE 6 LEGS**

**FIGURE 6**

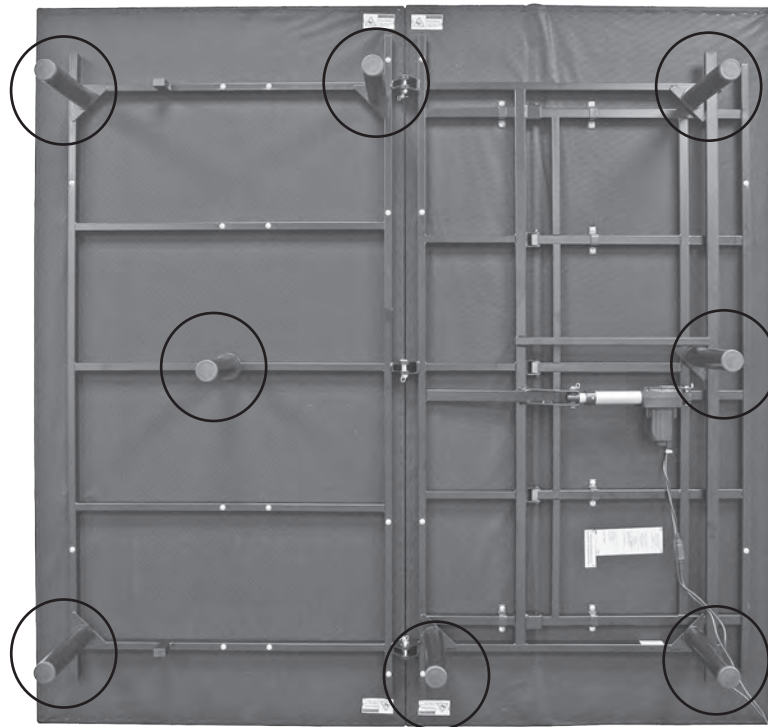

**KING BASES  
HAVE 8 LEGS**

## ASSEMBLY

### STEP 10

Rotate base over onto its legs.

### STEP 11



Operate remote control to verify base functions properly. If base does not operate, see the Troubleshooting section.

### STEP 12

Lower base to flat position.

### STEP 13

Install the mattress retainer. Place one end of the mattress retainer into the outside hole of the left insert and place the other end into the outside hole of right insert (FIGURE 7).

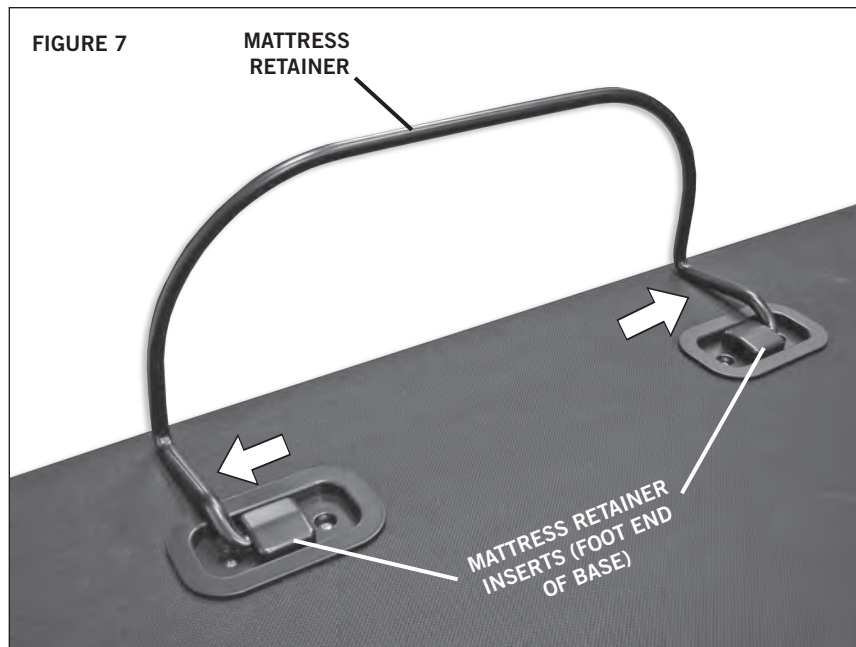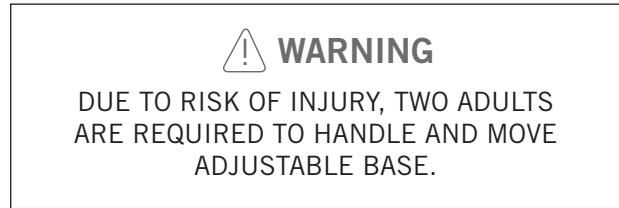

### STEP 14

Place mattress on base to complete assembly.



## REMOTE CONTROL FUNCTION

**HEAD UP BUTTON**  
Press and hold to  
raise the head section.

**HEAD DOWN BUTTON**  
Press and hold to lower  
the head section.



## TANDEM SYNCING

To tandem sync two bases to operate as one base, perform the following procedure:

### STEP 1

Locate the sync cable (FIGURE 8).

### STEP 2

Unplug both remote control cords from respective base motor cables.

### STEP 3

Plug one male end of sync cable into motor cable of base 1; place the other male end of sync cable into motor cable of base 2.

### STEP 4

Plug (1) remote control cord into female end of sync cable. Second remote is not needed. Retain for future use.


One remote control will now operate both bases.



### WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS. DO NOT WEAVE CORDS THROUGH BASE STRUCTURE.

**FIGURE 8**  
**SYNC CABLE**

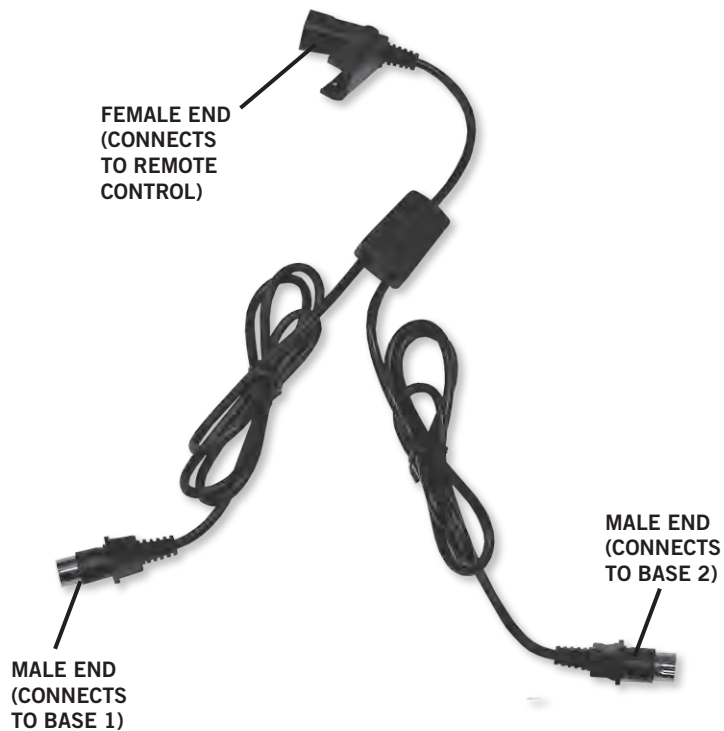

## TROUBLESHOOTING

If the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION
Remote control will not activate base.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. <b><i>A grounded, electrical surge protection device is recommended.</i></b> Test outlet by plugging in another working appliance.</li><li>• Verify remote control is plugged into the motor.</li><li>• Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components.</li><li>• Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify.</li><li>• Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.</li></ul>
Head section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction.</li><li>• Head section may be too close to the wall.</li></ul>

## CONTENIDO

Recomendaciones.....	13
Ensamblaje.....	14
Funcionamiento del Control Remoto.....	19
Sincronización en Tándem (un control remoto operando ambas bases en tándem).....	20
Resolución de Problemas.....	21



### **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**

Si la base ajustable no funciona o si hay partes faltantes,  
llame al: 800-888-3078  
Por favor no contacte a la tienda minorista o al distribuidor.

# RECOMENDACIONES

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### LEA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO



#### ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Entrada: 100-130 V, 50/60 Hz, 2.5 A. Máx. Salida: 29 VCC, 1.8 A.

#### CONEXIÓN A TIERRA

Este producto está equipado con un cable eléctrico conectado a tierra o polarizado. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

#### ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA

No abra ninguna caja de control, motor ni dispositivo del control manual (con la excepción de la caja de desconexión eléctrica). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes, si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de las partes de la base debe ser realizado por personal autorizado.

#### LUBRICACIÓN

Este producto está diseñado para no necesitar mantenimiento. Los motores de elevación están permanentemente lubricados y sellados, no se necesita lubricación adicional. No aplique lubricante a los tornillos de avance del motor de elevación ni a las tuercas de nilón, de lo contrario la cama puede deslizarse accidentalmente hacia abajo desde la posición elevada.

#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS

***Esta base está diseñada para uso en el hogar únicamente.*** No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No use esta base con equipo de terapia de oxígeno tipo tienda de campaña ni use cerca de gases explosivos. El fabricante no hace ninguna representación o garantía de que la base ajustable constituye un dispositivo médico o es adecuado para uso médico o terapéutico.

#### ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO

El nivel de sonido experimentado durante el funcionamiento de la cama se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada.

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los motores de elevación de la base no están diseñados para uso continuo. Logrará un funcionamiento confiable y una expectativa de vida útil completa siempre que los motores de elevación no funcionen durante más de cinco (5) minutos en un período de cincuenta (50) minutos o aproximadamente un 10% del ciclo de trabajo. Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso restringido recomendado para las bases ajustables es de 317 kg (700 lb) en todos los tamaños. Este producto no está diseñado para soportar o elevar esta cantidad sólo en la sección de la cabeza o de los pies. ***Nota: Exceder las restricciones recomendadas en cuanto a peso podría dañar la cama y anular la garantía.***

Para un mejor desempeño, los consumidores deben entrar y salir de la base ajustable con la base en la posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada. **NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.**

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones.

#### ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Después de sacar la base de la caja, deseche de inmediato el material de empaquetado pues puede asfixiar a niños pequeños o mascotas. Para evitar lesiones, no debe permitir que niños y mascotas jueguen abajo o encima de la base. Los niños no deben operar esta base sin la supervisión de un adulto.

#### REQUISITOS DE SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles, quitar cabeceras y pieceras o cualquier otro artículo requerido para realizar el mantenimiento a la base. En el caso de que el técnico no pueda realizar el servicio debido a falta de accesibilidad, la llamada de servicio se le cobrará al comprador y el servicio se tendrá que programar para otra fecha.

#### MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante la operación, las ruedas del brazo de elevación tienen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto aplica un poco de tensión a los componentes móviles y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones en exceso, invierta la acción de movimiento (arriba o abajo) de la base con el control manual. Esto debe realinear los mecanismos de activación de la base a la posición de operación apropiada.

## ENSAMBLAJE

Para montar la base ajustable, realice el siguiente procedimiento:

### PASO 1


Coloque el contenedor de envío de la base ajustable en una superficie sólida y nivelada. Retire la sección superior del contenedor de envío. Retire el material de empaque. Con cuidado, levante la base ajustable de la sección inferior del contenedor de envío y colóquela en una superficie limpia. Deje espacio suficiente para desplegar la base en el área de configuración.

### PASO 2

Levante la sección superior de la base ajustable y retire las cajas de piezas/patas.


### PASO 3

Retire de la bisagra la chaveta y el pasador de horquilla (hágalo en ambos lados) y despliegue la base ajustable hasta que quede plana (FIGURA 1).

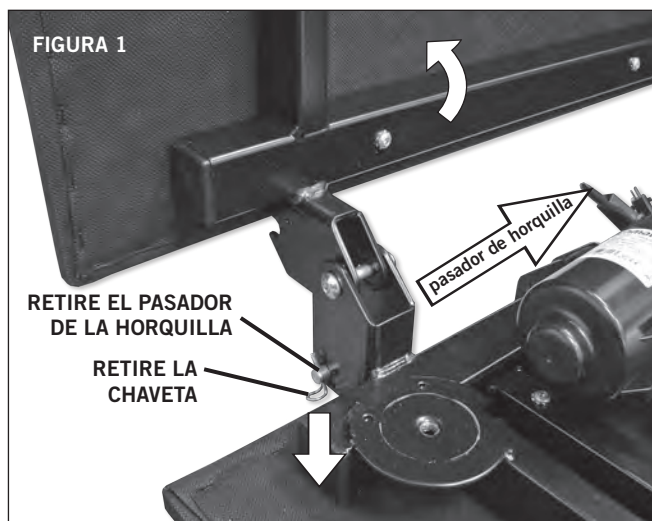

### PASO 4

Cuando la base esté plana, reinserte el pasador de horquilla y la chaveta (hágalo en ambos lados) (FIGURA 2).

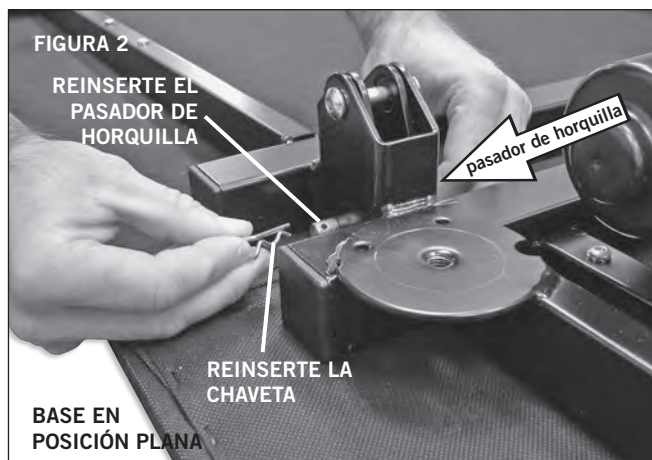

### ADVERTENCIA

DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.



### ADVERTENCIA

¡ PUNTOS DE COMPRESIÓN !  
MANTENGA LAS MANOS Y LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS BISAGRAS MIENTRAS SE DESPLIEGA LA BASE.



### NOTA

LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAN PUEDEN DIFERIR DEL PRODUCTO REAL.

## ENSAMBLAJE

### PASO 5

Abra la caja de envío de la base y verifique que se incluyan los siguientes elementos:

- (6 o 8) Patas de cama (dependiendo del tamaño de la base)
- (1) Control remoto
- (1) Retenedor de colchón (precintado al bastidor de la base)
- (1) Cable de sincronización (solo tamaños de dos piezas)
- (1) Manual del propietario



**PATA**  
(6 o 8 piezas,  
dependiendo del  
tamaño de la base)



**MANUAL DEL PROPIETARIO**



**CONTROL REMOTO**



**CABLE DE SINCRONIZACIÓN**  
(solo tamaños de dos piezas)



**RETENEDOR  
DE COLCHÓN**

## ENSAMBLAJE



### PASO 6

Retire el embalaje restante. Corte la abrazadera de plástico y quite el retenedor de colchón. **PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO AL UTILIZAR INSTRUMENTOS AFILADOS.**

Si configura dos bases gemelas para que funcionen como una base king (configuración en tándem), consulte la sección Sincronización en Tándem del manual antes de continuar.

### PASO 7

Enchufe el cordón del control remoto en el cable del motor de la base (FIGURA 3). Gire hacia abajo el gancho pestillo del cable y ajuste el gancho pestillo del cable a la posición cerrada (FIGURA 4). **Nota: Alinee los pines antes de insertar los enchufes (FIGURA 4). No pase los cables a través de la estructura de la base.**

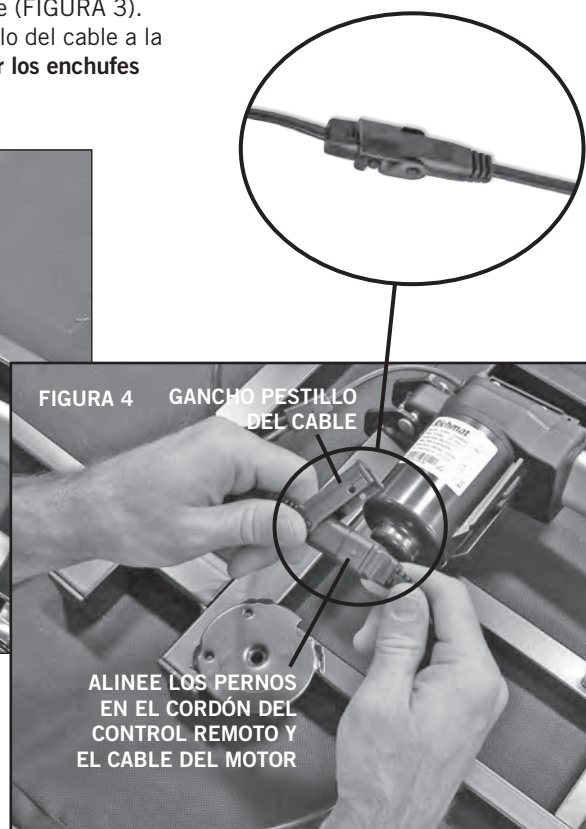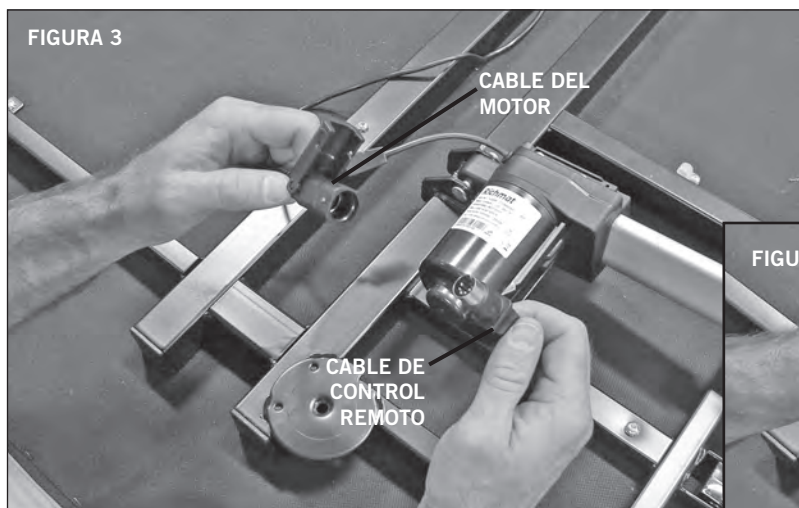

### PASO 8

Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra.

**Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobrevoltaje (no incluido).**



### ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.  
NO PASE LOS CABLES A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE.




## ENSAMBLAJE

### PASO 9


Atornille las patas en las placas para patas del bastidor de la base (FIGURAS 5 y 6).  
Apriete firmemente.

**FIGURA 5**

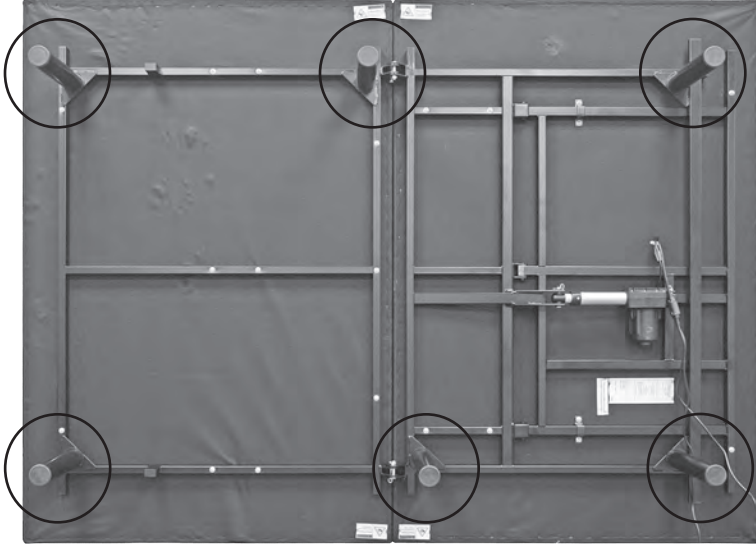

**LAS BASES QUEEN  
TIENEN 6 PATAS**

**FIGURA 6**

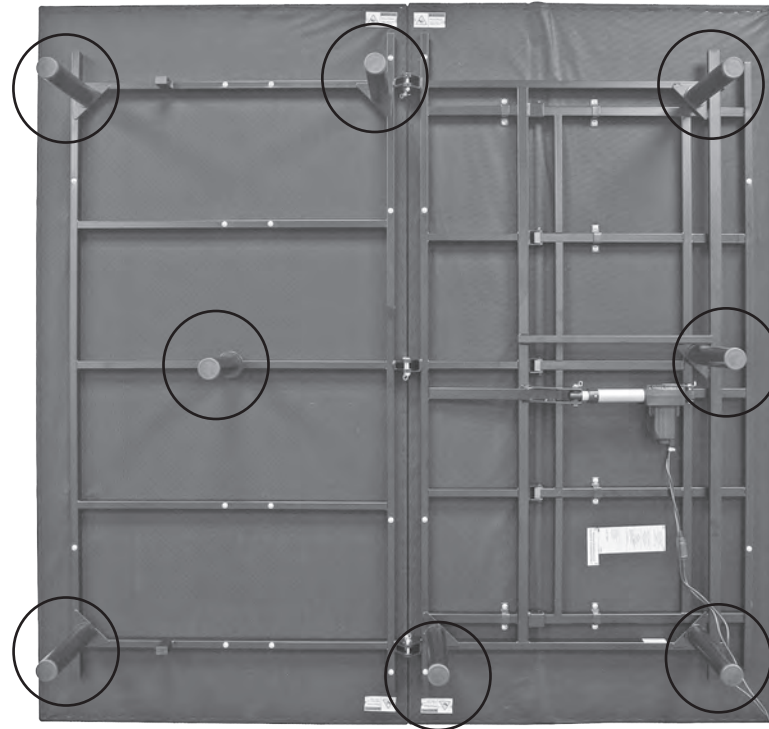

**LAS BASES KING  
TIENEN 8 PATAS**

## ENSAMBLAJE

### PASO 10

Gire la base sobre sus patas.

### PASO 11

Haga funcionar el control remoto para verificar que la base funcione correctamente. Si la base no funciona, consulte la sección de resolución de problemas.

### PASO 12

Baje la base hasta que quede en posición plana.


### PASO 13

Instale el retenedor de colchón. Coloque un extremo del retenedor del colchón en el orificio exterior del inserto izquierdo y coloque el otro extremo del retenedor del colchón en el orificio exterior del inserto derecho (FIGURA 7).



### ADVERTENCIA

DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.

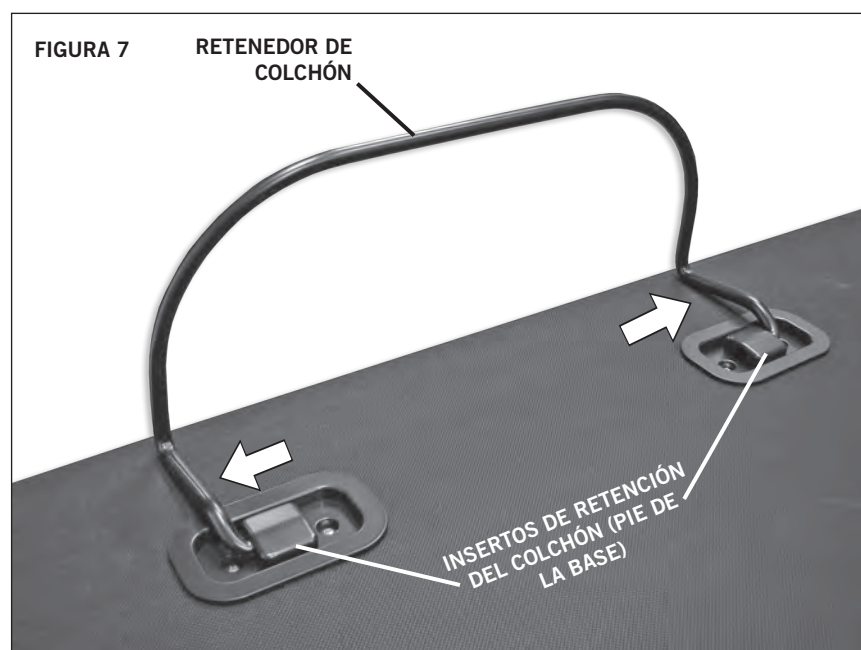

### PASO 14

Coloque el colchón sobre la base para completar el montaje.

## FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO

**BOTÓN PARA SUBIR LA CABEZA**  
Oprima y sostenga para subir la sección de la cabecera.

**BOTÓN PARA BAJAR LA CABEZA**  
Oprima y sostenga para bajar la sección de la cabecera.



## SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM

Si va a sincronizar en tándem dos bases para que operen como una sola, realice el siguiente procedimiento:

### PASO 1

Ubique el cable de sincronización (FIGURA 8).

### PASO 2

Desconecte ambos cables de los controles remotos de los respectivos cables de los motores de las bases.

### PASO 3

Conecte un extremo del enchufe macho del cable de sincronización en el cable del motor de la base 1; coloque el otro extremo del enchufe macho del cable de sincronización en el cable del motor de la base 2.

### PASO 4

Conecte (1) el cable del control remoto dentro del extremo del enchufe hembra del cable de sincronización. El segundo control remoto no se necesita. Conservar para uso futuro.

Ahora, un control remoto operará ambas bases.



### ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.  
NO PASE LOS CABLES A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE.

**FIGURA 8**  
**CABLE DE SINCRONIZACIÓN**



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la base ajustable no funciona, investigue los síntomas y las posibles soluciones que se proporcionan en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto no activará la base.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. <b>Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra.</b> Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.</li><li>• Verifique que el control remoto esté enchufado al motor.</li><li>• Desconecte el cable de alimentación, espere 30 segundos y conéctelo para restablecer los componentes electrónicos.</li><li>• Se podría activar el interruptor eléctrico. Revise la caja del interruptor del servicio eléctrico para verificar.</li><li>• Dispositivo de protección contra descargas eléctricas defectuoso o la toma de corriente. Conecte la toma de corriente a otro aparato que funcione para probarla.</li></ul>
Se eleva la sección de cabeza, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	<ul style="list-style-type: none"><li>• El mecanismo de la base puede estar obstruido. Eleve la base y revise si hay alguna obstrucción. Retire la obstrucción.</li><li>• La sección de la cabeza puede estar muy cerca de la pared.</li></ul>

## CONTENU

Avis.....	23
Instructions de montage.....	24
Fonctionnement de la télécommande .....	29
Synchronisation en tandem (une seule télécommande pour faire fonctionner les deux bases en tandem).....	30
Résolution de problèmes .....	31



### **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BASE**

Si la base ajustable ne fonctionne pas ou s'il manque des pièces, composer le numéro de téléphone sans frais : 1-877-452-2665.

Prière de ne pas communiquer avec le revendeur ni le magasin.

## AVIS

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

#### LIRE LES RENSEIGNEMENTS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT



#### AVERTISSEMENT

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE LA BASE AJUSTABLE, UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ÉLECTRIQUES MISE À LA TERRE (NON INCLUS). LE FAIT DE NE PAS UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT ENTRAÎNER UN DANGER OU UN DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Entrée : 100-130 VAC, 50/60Hz, 2,5 A. max. Sortie : 29 VDC, 1,8 A.

#### MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

Ce produit est équipé d'un câble d'alimentation électrique polarisé ou relié à la terre. Le câble d'alimentation ne peut être branché que dans un dispositif de protection contre les surtensions électriques (non inclus) ou dans une prise électrique mise à la terre.

#### AVERTISSEMENT RELATIF À LA GARANTIE

Ne pas ouvrir les boîtes de commande, les moteurs ni les télécommandes (à l'exception du compartiment de piles). La garantie du produit sera annulée si ces composants sont manipulés. La garantie sera également annulée si le câblage des composants est altéré ou si la structure du produit est ajustée ou modifiée de quelque façon que ce soit. Toute réparation ou tout remplacement des composants de la base doit être effectué par du personnel autorisé.

#### LUBRICATION

La base est conçue pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de levage sont scellés et lubrifiés en permanence. Aucune lubrification supplémentaire n'est requise. Ne pas utiliser de lubrifiant pour soulever les vis-mère du moteur ou les écrous nyloc, car la base pourrait glisser par inadvertance vers le bas lorsqu'elle est en position élevée.

#### CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR UTILISATION EN MILIEU HOSPITALIER

*Cette base est conçue uniquement pour un usage à domicile.* Elle n'est pas approuvée pour une utilisation en milieu hospitalier et n'est pas conforme aux normes des hôpitaux. N'utilisez pas cette base avec un équipement d'oxygénothérapie de type tente ni près de gaz explosifs. Le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie que la base ajustable constitue un appareil médical ni qu'elle convienne pour un usage médical ou thérapeutique.

#### EMPLACEMENT DE LA BASE

Lorsqu'elle est sous tension, le niveau de bruit provenant de la base est directement lié à l'endroit où la base est installée.

#### CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT

Les moteurs de levage de la base ne sont pas conçus pour un usage continu. La base fonctionnera correctement et aura une durée de vie complète seulement si les moteurs de levage ne fonctionnent pas d'une manière continue pendant plus de cinq (5) minutes sur une période de cinquante (50) minutes, c.-à-d. environ 10 % du cycle de service. Toute tentative de contourner ou de dépasser ces caractéristiques nominales raccourcira la durée de vie du produit et risque d'annuler la garantie.

La limite de poids recommandée pour la base ajustable est de 700 lb (317 kg) pour toutes les tailles. La structure de la base supportera le poids recommandé s'il est réparti uniformément entre la tête et les pieds. Les différentes sections de la base ne sont pas conçues pour soutenir ou soulever le poids total.

**Nota : Le non-respect de la limite de poids recommandée pourrait endommager la base et annuler la garantie.**

Pour obtenir les meilleurs résultats, le client devrait s'allonger sur la base ajustable ou la quitter que lorsqu'elle est en position à plat (position horizontale). Éviter de placer la totalité du poids sur la section de la tête ou des pieds, y compris lorsque la base est en position relevée. **EST STRICTEMENT DÉCONSEILLÉ DE SE TENIR DEBOUT SUR LA BASE.**

Les moteurs et les composants électroniques ont été testés ETL selon les normes de UL (Underwriters Laboratories).

La base est approuvée CFR 1633 et convient à la plupart des matelas.

#### AVERTISSEMENT RELATIF AUX JEUNES ENFANTS ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Une fois la base déballée, jeter immédiatement le matériel d'emballage car les jeunes enfants et les animaux domestiques pourraient s'étouffer. Pour éviter les blessures, les enfants et les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sous ou sur la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base sans la surveillance d'un adulte.

#### EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

Les techniciens de service ne sont pas tenus de déplacer des meubles, de retirer la tête ou le pied de lit ou tout autre composant pour effectuer les tâches d'entretien sur la base. Dans l'éventualité où le technicien est incapable de fournir le service parce qu'il lui est impossible d'accéder à la base, l'appel de service sera tout de même facturé à l'acheteur et devra être reporté à une date ultérieure.

#### MÉCANISMES DE LEVAGE ET D'ABAISSEMENT

La fonction de soulèvement et d'abaissement émettra un bourdonnement pendant son opération. Ceci est normal.

Pendant l'opération, les roues du bras de levage entrent en contact avec la plateforme du support de la base. Ceci crée une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimal. S'il y a un excès de bruit ou de vibration, inversez le mouvement (monter ou descendre) de la base avec la télécommande. Ceci devrait réaligner les mécanismes de la base avec la bonne position d'opération.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour l'installation de la base ajustable, suivez les instructions suivantes :

### ÉTAPE 1

Placer le contenant d'expédition de la base ajustable sur une surface horizontale, solide. Retirer le couvercle du contenant d'expédition. Enlever le matériel d'emballage. Retirer soigneusement la base ajustable du contenant d'expédition et la placer sur une surface propre. Prévoyez suffisamment d'espace pour pouvoir déplier la base complètement dans l'emplacement désiré.

### ÉTAPE 2

Soulever la partie supérieure de la base ajustable et retirer les boîtes de quincaillerie/pattes de lit.

### ÉTAPE 3

Retirez la goupille fendue et l'axe de chape de la charnière (une de chaque côté) et déployez à plat la base ajustable (FIGURE 1).



### AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.




### AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!  
GARDER LES MAINS ET LES DOIGTS LOIN DES CHARNIÈRES QUAND VOUS DÉPLIEZ LA BASE.




### NOTA

LES IMAGES PEUVENT DIFFÉRER DU PRODUIT RÉEL.

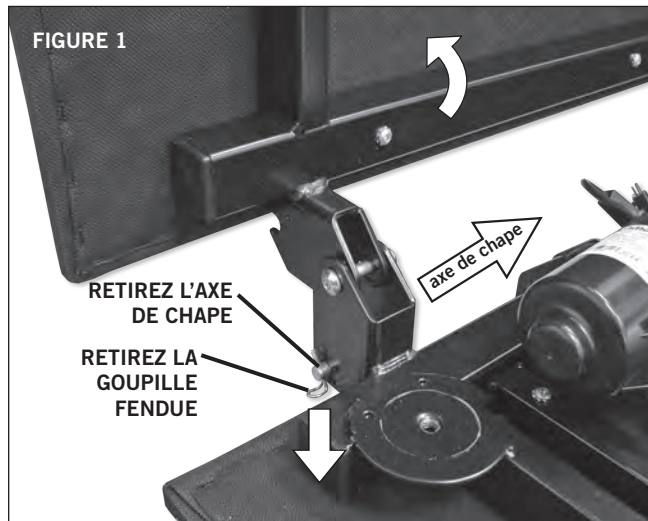

### ÉTAPE 4

Lorsque la base est à plat, réinsérez l'axe de chape et la goupille fendue (une de chaque côté) (FIGURE 2).

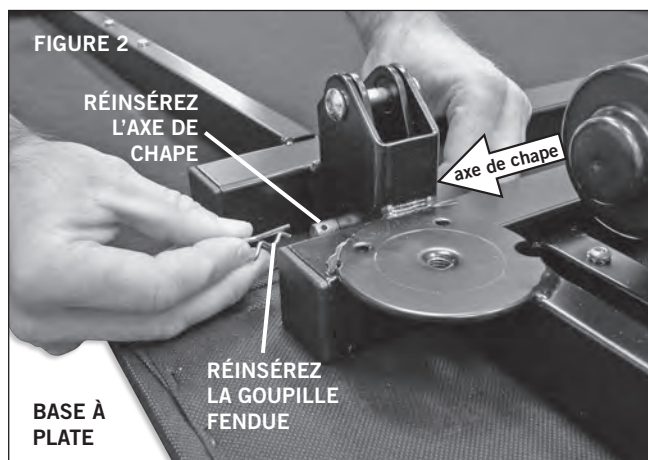



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### ÉTAPE 5

Ouvrir la boîte de quincaillerie et vérifier que les composants suivants sont inclus :

- (6 ou 8) Pattes de lit (selon le type de base)
- (1) Télécommande
- (1) Dispositif de retenue pour matelas (couper l'attache mono-usage pour le détacher)
- (1) Cable de synchronisation (lits divisés seulement)
- (1) Manual d'utilisation



**PATTES**  
(6 ou 8, selon le type de base)



**MANUAL D'UTILISATION**



**TÉLÉCOMMANDE**



**CÂBLE DE SYNCHRONISATION**  
(lits divisés seulement)



**DISPOSITIF DE RETENUE DE MATELAS**

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### ÉTAPE 6



Retirer l'emballage restant. Coupez l'attache mono-usage et enlevez le dispositif de retenue du matelas. **AVERTISSEMENT : PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION D'OBJETS TRANCHANTS.**

Pour l'utilisation de deux bases simples comme une base de Très grand lit (tandem), consulter la section sur la synchronisation en tandem du manuel avant de poursuivre l'installation.

### ÉTAPE 7

Brancher le cordon de la télécommande dans le câble du moteur de la base (FIGURE 3). Faire glisser le verrou vers le bas et placer le verrou du câble en position fermé.

**Nota : Aligner les tiges avant de les insérer dans les trous. (FIGURE 4). Il est strictement déconseillé de faire passer les cordons à travers la structure de la base.**

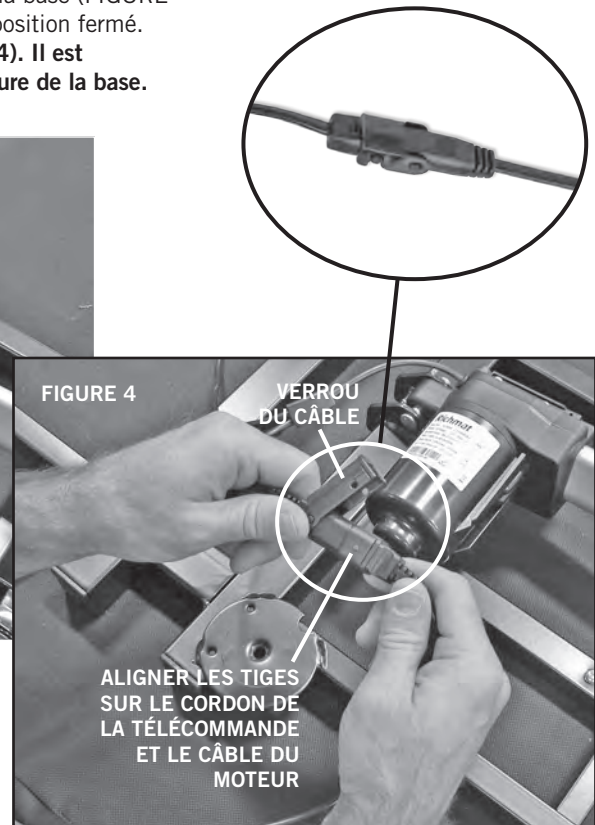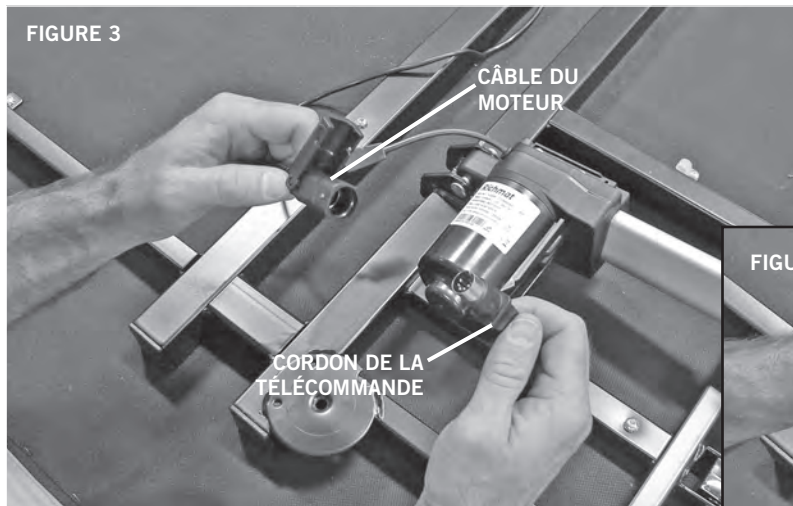

### ÉTAPE 8

Branchez le cordon électrique dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre.

**Nota : il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions électriques (non inclus).**



### AVERTISSEMENT

LES CORDONS D'ALIMENTATION NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DE LA BASE RÉGLABLE.


NE FAITES PAS PASSER LES CORDONS À TRAVERS LA STRUCTURE DE LA BASE.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### ÉTAPE 9


9 Insérer les pattes dans les plaques sous le cadre de la base (FIGURES 5 et 6). Bien visser en place.

**FIGURE 5**

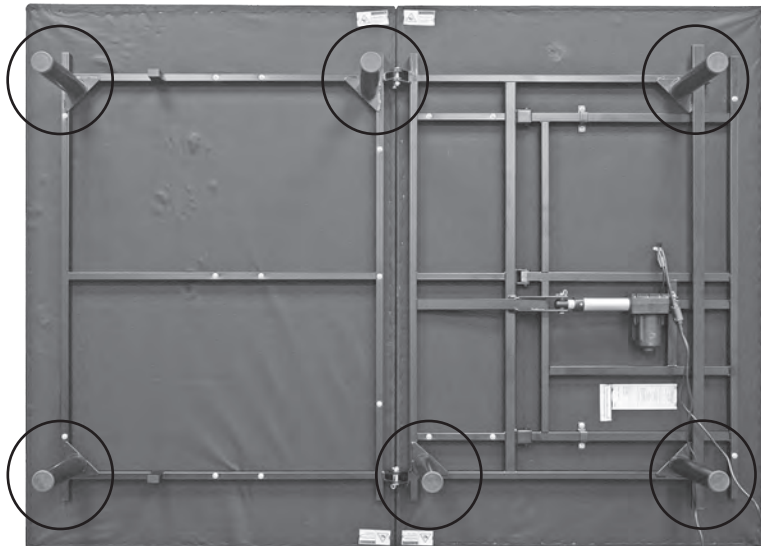

**LES BASES DE GRAND  
LIT ONT 6 PATTES**

**FIGURE 6**

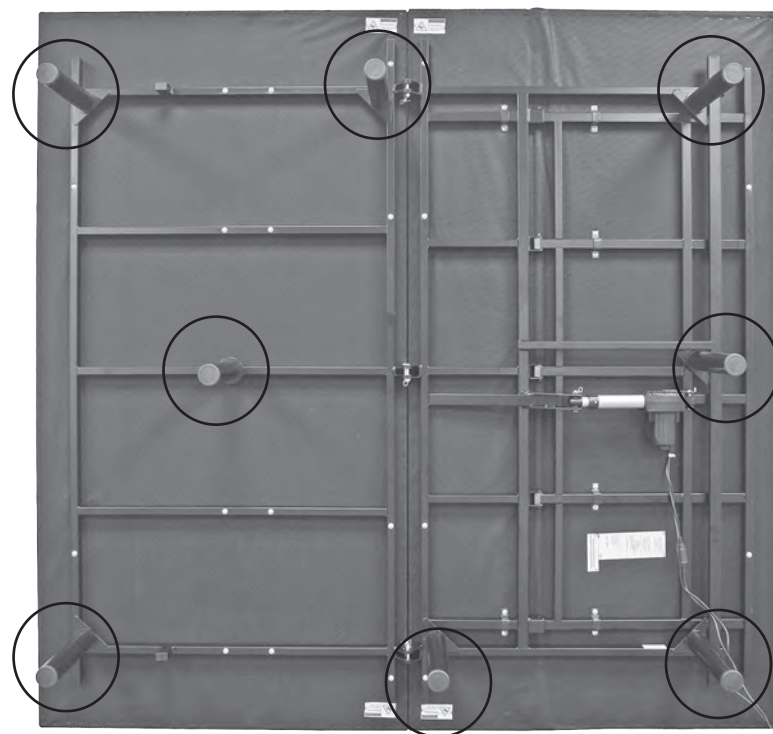

**LES BASES DE TRÈS GRAND  
LIT ONT 8 PATTES**

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### ÉTAPE 10

Retourner la base pour qu'elle repose sur ses pattes.

### ÉTAPE 11

Faire fonctionner la télécommande pour s'assurer que la base fonctionne correctement. Si la base ne fonctionne pas correctement, consulter la section Résolution de problèmes.

### ÉTAPE 12

Rabaisser la base pour qu'elle soit en position horizontale.


### ÉTAPE 13

Fixer le dispositif de retenue de matelas en plaçant une extrémité du dispositif dans l'oeillet extérieur de la capsule de gauche et l'autre extrémité dans l'oeillet extérieur de la capsule de droite (FIGURE 7).



### AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURE,  
IL FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER  
ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.

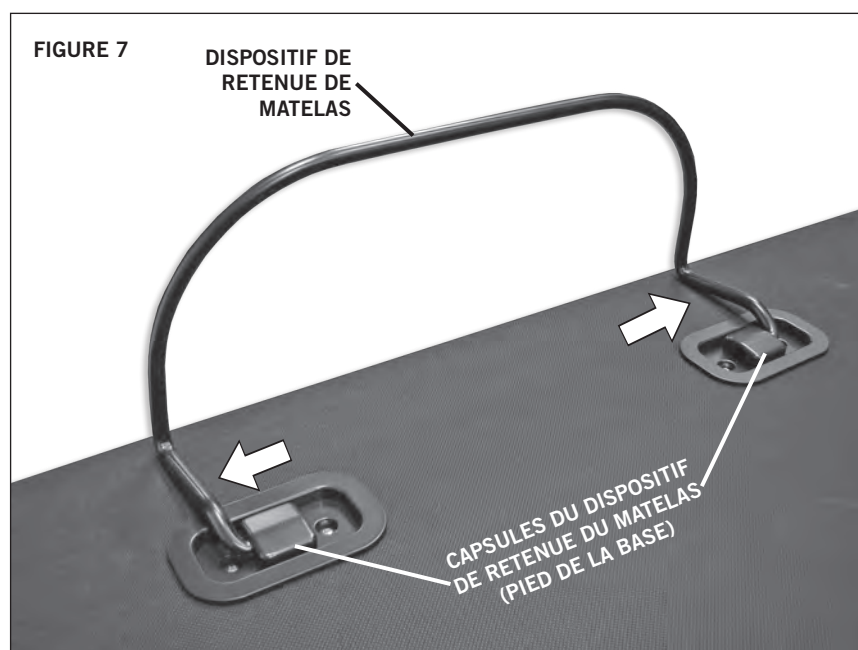

### ÉTAPE 14

Placer le matelas sur la base pour terminer le montage.

## FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

**BOUTON TÊTE RELEVÉE**  
Appuyer sur le bouton et  
maintenir pour relever la  
section de la tête.

**BOUTON TÊTE RABAISSÉE**  
Appuyer sur le bouton et  
maintenir pour rabaisser la  
section de la tête.



## SYNCHRONISATION EN TANDEM

Pour synchroniser les deux bases en tandem afin de les faire fonctionner comme une seule base, suivez les étapes suivantes :

### ÉTAPE 1

Localiser le câble de synchronisation (FIGURE 8).

### ÉTAPE 2

Débranchez les deux câbles de télécommande des connexions respectives des moteurs des bases.

### ÉTAPE 3

Branchez une extrémité mâle du câble de synchronisation dans le câble de la base 1; placer l'autre extrémité mâle du câble de synchronisation dans le câble du moteur de la base 2.

### ÉTAPE 4

Branchez (1) cordon de télécommande dans l'extrémité femelle du câble de synchronisation. La deuxième télécommande n'est pas nécessaire. Conservez-la pour une utilisation ultérieure.

La télécommande peut maintenant opérer les deux bases.




### AVERTISSEMENT

LES CORDONS D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS TOUCHER AUX MÉCANISMES DE LA BASE RÉGLABLE. NE PAS FAIRE PASSER LES CORDONS À TRAVERS LA STRUCTURE DE LA BASE.

**FIGURE 8**

### CÂBLE DE SYNCHRONISATION

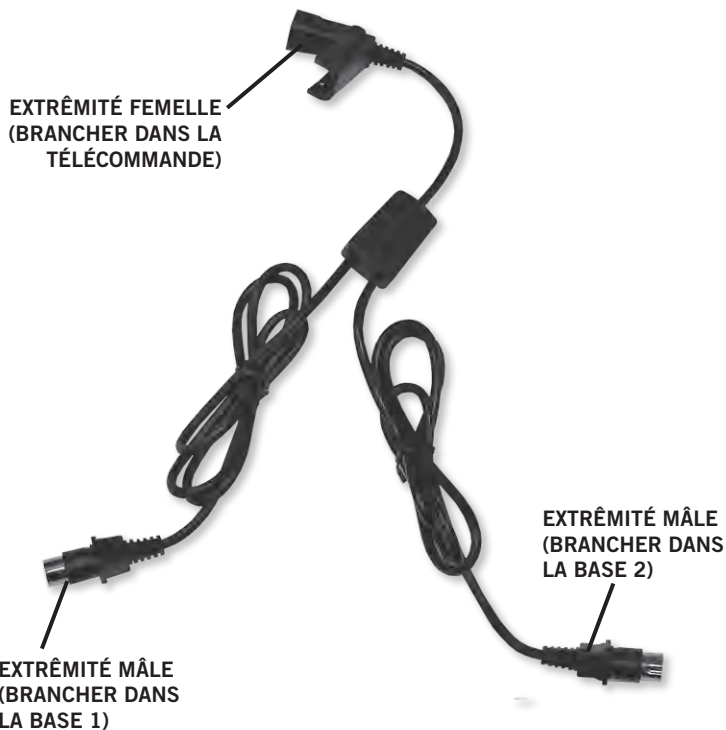

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le lit ajustable ne fonctionne pas correctement, examiner les symptômes et les solutions possibles mentionnés dans le tableau ci-dessous :

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande n'active pas la base.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique mise à la terre et fonctionnelle. <b>Un dispositif de protection contre les surtensions, mis à la terre est recommandé.</b> Testez la prise en branchant un autre appareil qui fonctionne.</li><li>• Vérifiez que la télécommande est branchée dans le moteur.</li><li>• Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes et rebranchez-le pour réinitialiser les composants électroniques.</li><li>• Le disjoncteur électrique s'est peut-être déclenché. Vérifiez la boîte des disjoncteurs d'installation électrique.</li><li>• Dispositif de limiteur de surtension ou prise électrique défectueux. Testez la prise en branchant un autre appareil qui fonctionne.</li></ul>
La section de la tête ou du pied s'élève, mais ne revient pas à la position horizontale (à plat).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le mécanisme de la base peut être obstrué. Soulevez la base et vérifiez s'il y a une obstruction. Retirez ce qui cause l'obstruction.</li><li>• La section de la tête est peut-être trop près du mur.</li></ul>

